

MANUAL DE USUARIO

HR40 Monitor de Frecuencia Cardiaca

www.igpsport.com

WUHAN QIWU TECHNOLOGY CO., LTD

Directorio

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO.....	1
2. CONTENIDO.....	1
3. ACOMODAR EL MONITOR HR40.....	1
4. MANTENIMIENTO.....	3
5. DISPOSITIVOS COMPATIBLES.....	3
6. BATERÍA.....	4
7. CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO MAESTRO (ANT+ O BLUETOOTH 4.0).....	5
8. ESPECIFICACIONES.....	6
9. CONTACTA CON NOSOTROS.....	7
10. Declaración.....	7

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Con conexión ANT+ y Bluetooth, el HR40 soporta la conexión con ciclo computadores iGPSPORT, smartphones o relojes deportivos (con protocolo ANT+ o Bluetooth y habilitados para mostrar la frecuencia cardiaca) para sincronizar y mostrar en tiempo real los datos de frecuencia cardiaca de cada ejercicio.

Nota:

El HR40 funciona únicamente para proporcionar datos de frecuencia cardiaca mientras se practica el deporte como un dispositivo de referencia de asistencia, no puede reemplazar ningún consejo médico.

2. CONTENIDO

- 1x Monitor de frecuencia cardiaca HR40
- 1x Correa para el pecho
- 1x Manual de usuario

3. ACOMODAR EL MONITOR HR40

3.1. Humedezca el área del electrodo de la correa de pecho.



3.2. Coloque el monitor de ritmo cardiaco en la correa del pecho. Por favor, tenga en cuenta que el lado izquierdo y el lado derecho deben estar en concordancia con su mano izquierda y derecha.


L-izquierda / R-derecha. Mantenga el loso de IGSPORT hacia arriba.



3.3. Ajuste la longitud de la correa para que se acople a su pecho de manera firme y cómoda y asegúrese de que el área húmeda del electrodo toque firmemente la piel.

Nota:

- Use el dispositivo cerca del corazón para obtener señales de frecuencia cardíaca más estables.
 - Usa la correa demasiado floja, en incorrecta posición o con un ajuste inadecuado podría causar una conexión pobre y la perdida ocasional de la señal.
- Por favor, ajuste la longitud de la correa correctamente para que se fije a su pecho y obtenga una conexión efectiva.

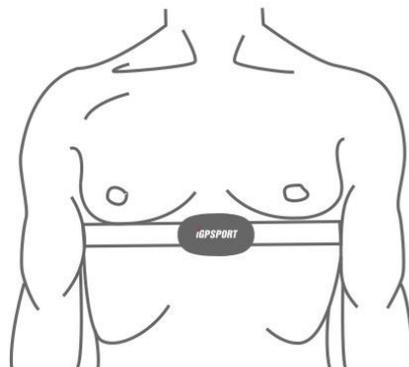

4. MANTENIMIENTO

Un mantenimiento adecuado, como el descrito a continuación, alargará el tiempo de vida y uso del HR40.

- Monitor de frecuencia cardiaca

Separe el monitor de frecuencia cardiaca de la correa cuando no lo esté usando y límpielo con paño suave sin usar ningún tipo de producto limpiador químico.

- Correa

Lavar a mano la correa con agua limpia y séquela de forma natural. No use lavadora ni secadora para su lavado.

No use ningún limpiador químico para lavar (causará daños y acortará la vida útil de la correa).


No sobreestire la correa ni la doble en la zona del electrodo.

Guarde la correa en un lugar fresco, seco y donde no corra el aire.

5. DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Con ANT+ y Bluetooth, el HR60 admite la conexión con ciclo computadores iGPSPORT, smartphones o relojes deportivos (con protocolo ANT+ ó Bluetooth y habilitados para medir la frecuencia cardiaca) para sincronizar y mostrar los datos de frecuencia cardíaca en tiempo real.

(Nombre de HR40 mediante Bluetooth: **HRM_Sensor**)

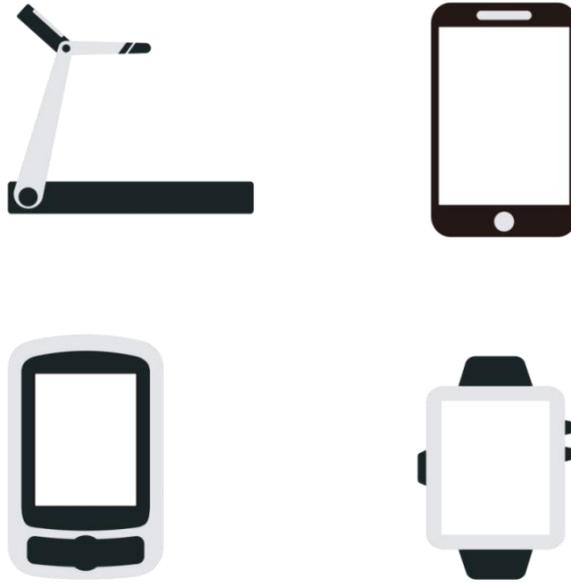

6. BATERÍA

El HR40 funciona con una pila de botón CR2032 (ya instalada) con autonomía de hasta 340 horas. (El dispositivo entrará en modo 'sleep' para conseguir un muy bajo consumo mientras no se está usando.)

Cambio de batería

- Retire la tapa de la batería usando una moneda para girar la tapa de la batería hacia el lado izquierdo.




- Deseche la pila de acuerdo con la normativa y legislación local.



- Instale la nueva pila (mantenga el lado positivo (+) hacia arriba) y use una moneda para girar la tapa de la batería hacia el lado derecho.

Para evitar situaciones peligrosas mantenga las pilas alejadas de niños y fuego.

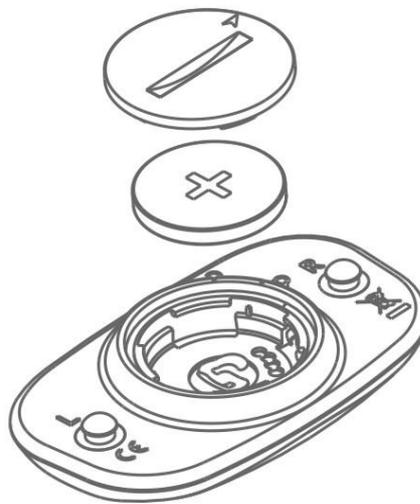

7. CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO MAESTRO (ANT+ O BLUETOOTH 4.0)

Pasos:

1. Colóquese el monitor de frecuencia cardiaca HR40 de forma correcta para activarlo.
2. Busque el monitor de frecuencia cardiaca siguiendo los pasos del dispositivo al que quiere conectarlo (GPS, Ciclocomputador, App para smartphones...)

Notas:

1. El HR40 es compatible con el protocolo estándar ANT+ como monitor de frecuencia cardiaca.
2. El HR40 es compatible con la transmisión inalámbrica Bluetooth 4.0 como monitor de frecuencia cardiaca.

8. ESPECIFICACIONES

Dispositivo	Monitor de frecuencia cardiaca de doble banda con alta sensibilidad.
Resistencia al agua	IPX7
Longitud correa del pecho	65-95 cm
Peso	49±1g (pila de botón CR2032 incluida)
Dimensiones	59.8×35.5×11.9 mm
Rango de medición	40-240 lpm
Transmisión inalámbrica	Bluetooth 4.0 y ANT+ / 2.4G
Autonomía	Hasta 340 horas (uso normal)
Contenido	1x HR40 1x Correa para el pecho 1x Manual de usuario

9. CONTACTA CON NOSOTROS

España y Portugal:

Web española: www.igpsport.es

Distribuidor oficial: DOPE WALIO S.L.

Dirección: Av. Manoteras 38, 28050, Madrid

Tel: +34 912330044

Email: hola@igpsport.es

Global:

Web internacional: www.igpsport.com

Fabricante: Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd

Dirección: Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China.

Tel: (86) 27-87835568

Email: info@igpsport.com, service@igpsport.com

10. Declaración

El manual del usuario es solo para referencia del usuario. Por favor, si existe alguna discrepancia entre el manual y el dispositivo, se impone el dispositivo. Nos reservamos el derecho de cambiar o mejorar nuestros productos y hacer cambios en el contenido de este manual sin obligación de notificar a ninguna persona u organización sobre dichos cambios o mejoras. Todos los derechos reservados por Wuhan Qiwu Technology Company, Ltd